

発生場所  
気研室棟

原子力科学研究所  
施設の位置

..... 周辺監視区域境界  
—— 敷地境界

太  
平  
洋

至日立



MP-11

MP-19

正門

南門

MP-18

MP-17

MP-16

MP-13

MP-14

MP-15

常陸南太田10

向山

常陸自動車道

船場

佐和

高崎

さわ

石神外宿

常陸線

白方

村松

風原


日本原子力発電(株)

日本原子力研究開発機構  
原子力科学研究所


核燃料サイクル  
工学研究所

MP-12

# 第1研究棟(1・2・3階)

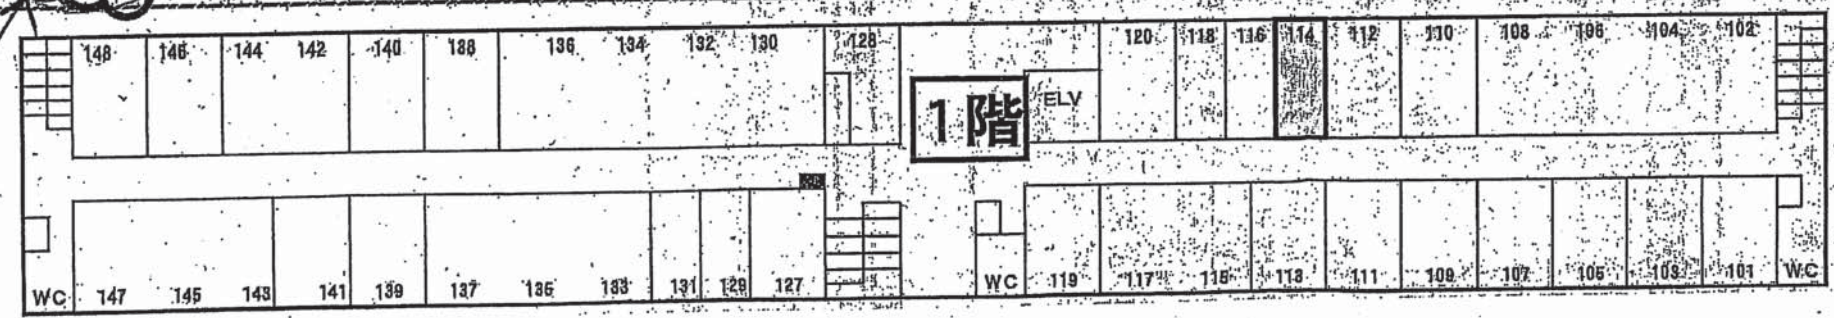

第1研究棟2階247号室(非管理区域)

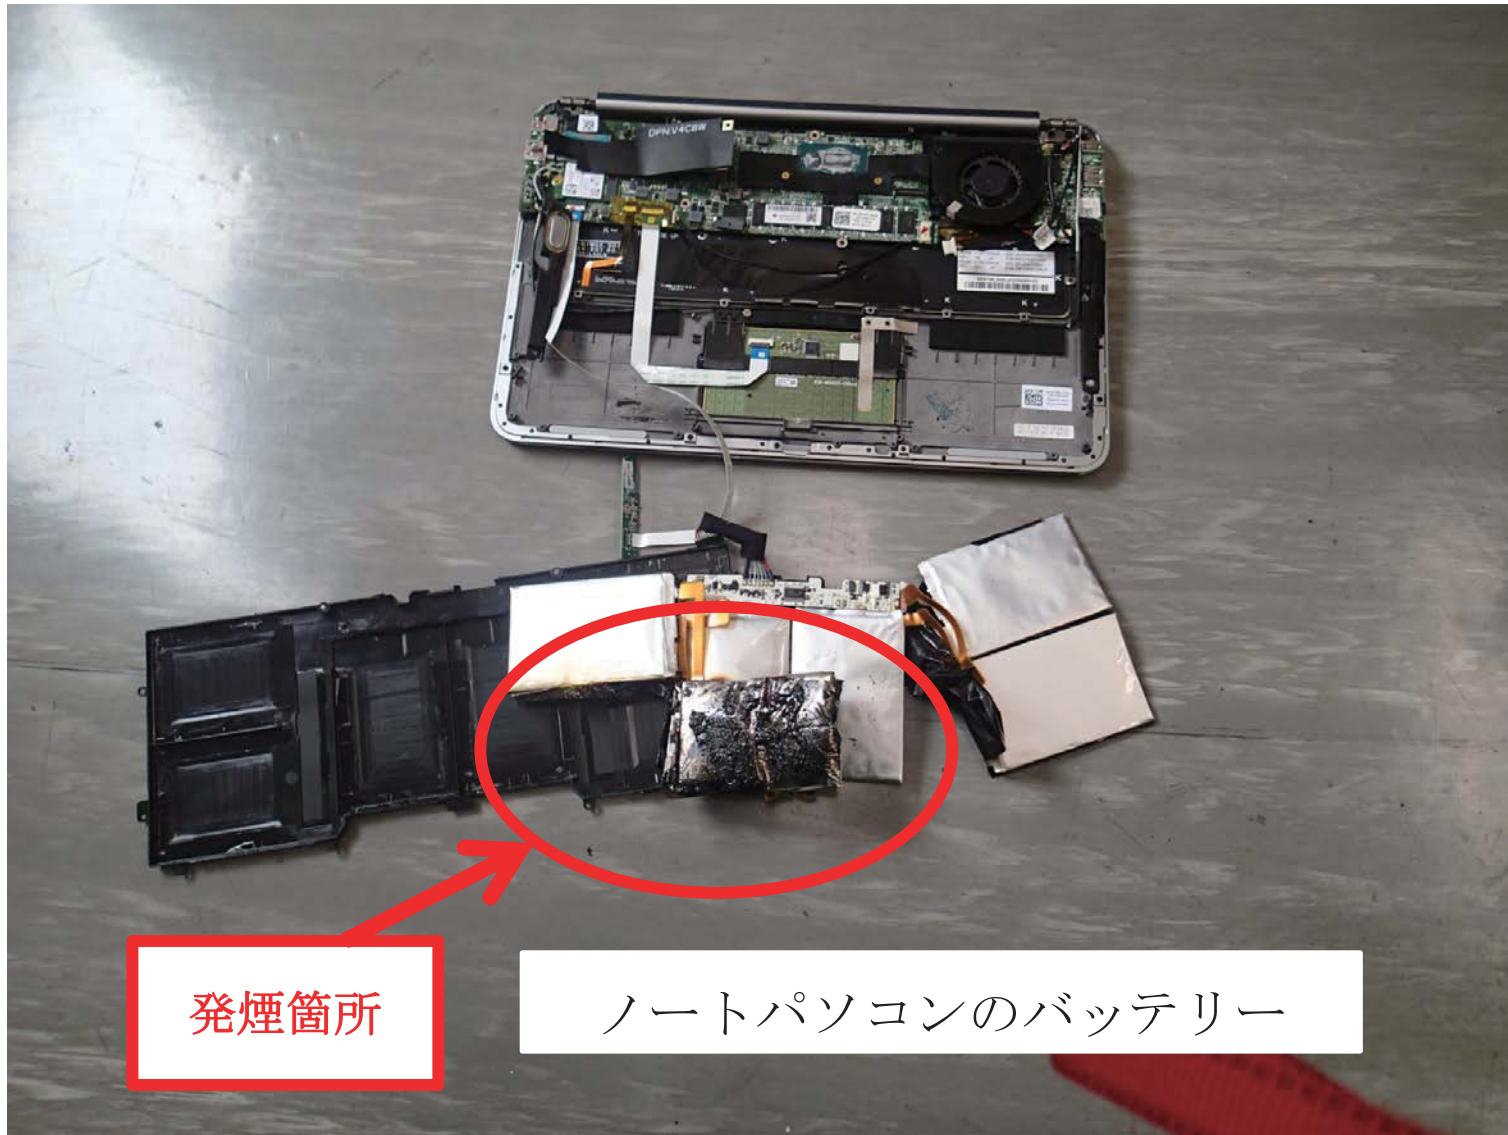

発煙箇所

ノートパソコンのバッテリー